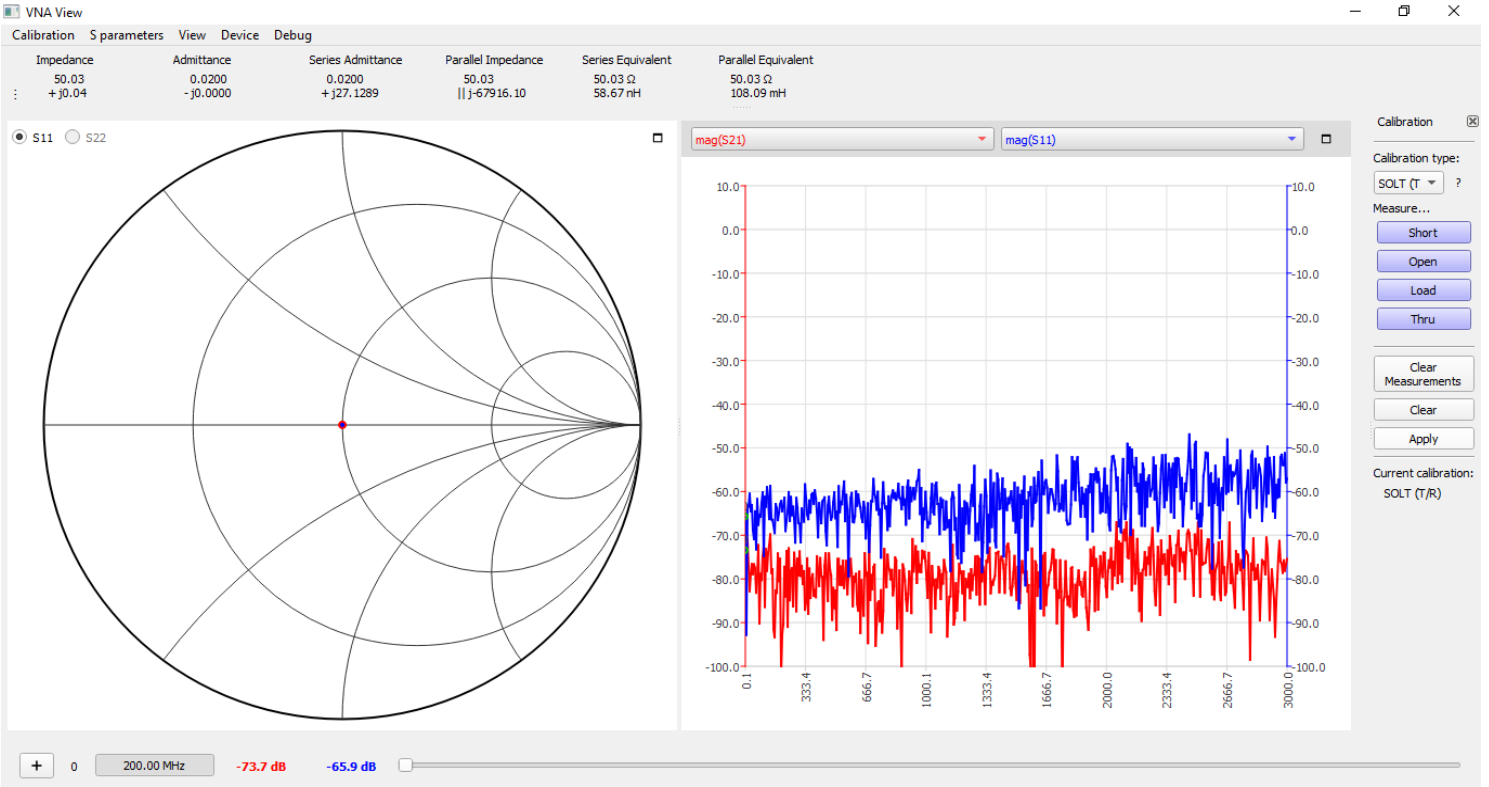
VNA View
Calibration
S parameters
View
Device
Debug
Impedance
50.03
+ j0.04
Admittance
0.0200
- j0.0000
Series Admittance
0.0200
+ j27.1289
Parallel Impedance
50.03
|| j-67916.10
Series Equivalent
50.03 Ω
58.67 nH
Parallel Equivalent
50.03 Ω
108.09 mH
S11
S22
mag(S21)
mag(S11)
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0
-60.0
-70.0
-80.0
-90.0
-100.0
0.1
333.4
666.7
1000.1
1333.4
1666.7
2000.0
2333.4
2666.7
3000.0
Calibration
Calibration type:
SOLT (T
?
Measure...
Short
Open
Load
Thru
Clear Measurements
Clear
Apply
Current calibration:
SOLT (T/R)
0
200.00 MHz
-73.7 dB
-65.9 dB