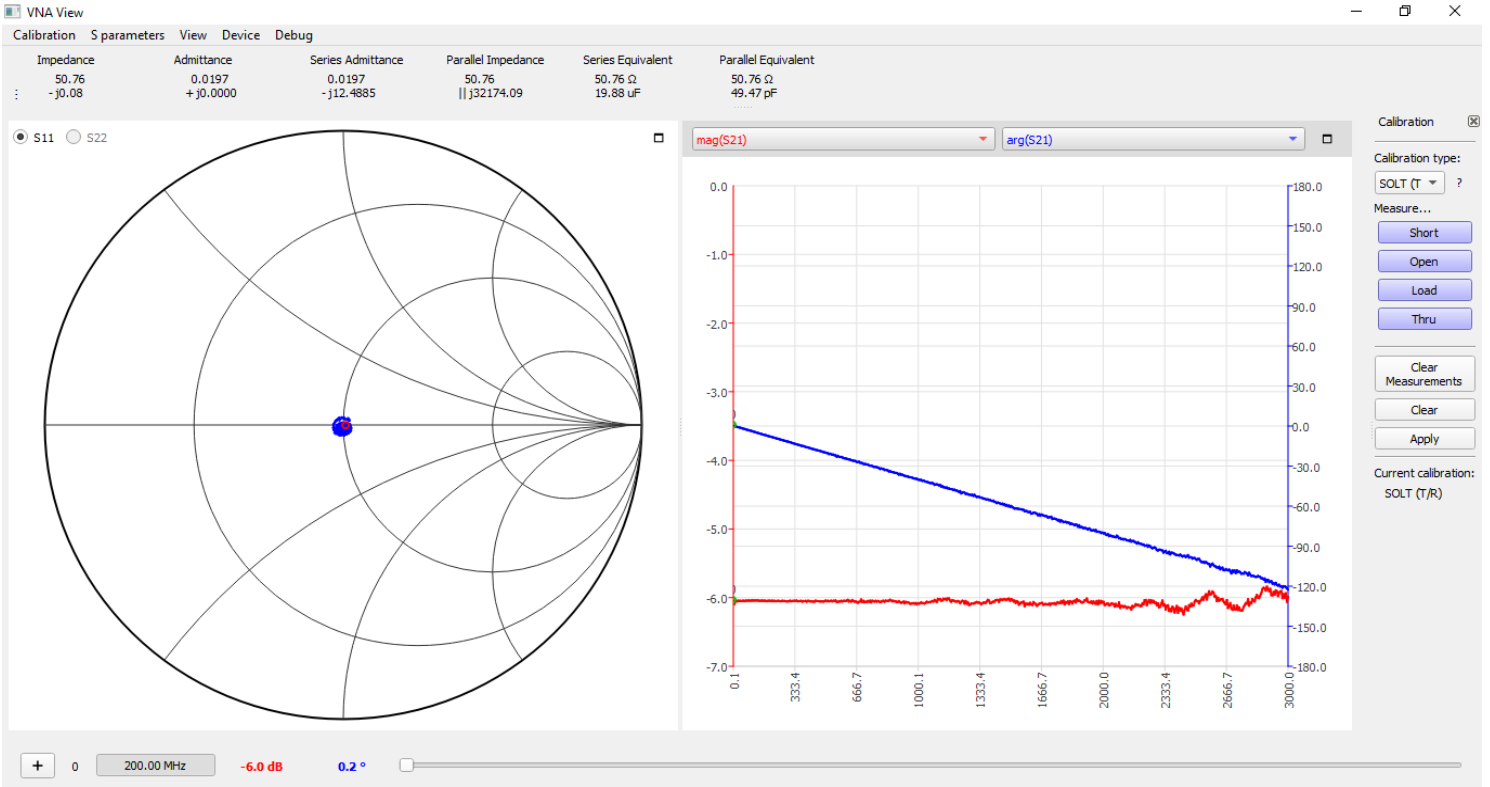
VNA View
Calibration
S parameters
View
Device
Debug
Impedance
50.76
- j0.08
Admittance
0.0197
+ j0.0000
Series Admittance
0.0197
- j12.4885
Parallel Impedance
50.76
|| j32174.09
Series Equivalent
50.76 Ω
19.88 uF
Parallel Equivalent
50.76 Ω
49.47 pF
S11
S22
mag(S21)
arg(S21)
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
180.0
150.0
120.0
90.0
60.0
30.0
0.0
-30.0
-60.0
-90.0
-120.0
-150.0
-180.0
0.1
333.4
666.7
1000.1
1333.4
1666.7
2000.0
2333.4
2666.7
3000.0
Calibration
Calibration type:
SOLT (T
?
Measure...
Short
Open
Load
Thru
Clear Measurements
Clear
Apply
Current calibration:
SOLT (T/R)
+
0
200.00 MHz
-6.0 dB
0.2 °